

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений  
№ 91185-24

Срок действия утверждения типа до 29 января 2029 г.

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
Расходомеры электромагнитные СИМАГ 23

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Геолинк Ньютек"  
(ООО "Геолинк Ньютек"), г. Москва

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Геолинк Ньютек"  
(ООО "Геолинк Ньютек"), г. Москва

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
МП 208-054-2023

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 5 лет

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 29 января 2024 г. N 243.

Заместитель Руководителя

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,  
хранится в системе электронного документооборота  
Федерального агентства по техническому регулированию и  
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E9C42A3360155561666DB4E2E05F7B52  
Кому выдан: Кузьмин Александр Михайлович  
Действителен: с 18.12.2023 до 12.03.2025

А.М.Кузьмин

«12» февраля 2024 г.

**УТВЕРЖДЕНО**  
приказом Федерального агентства  
по техническому регулированию  
и метрологии  
от «29» января 2024 г. № 243

Регистрационный № 91185-24

Лист № 1  
Всего листов 10

**ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ**

**Расходомеры электромагнитные СИМАГ 23**

**Назначение средства измерений**

Расходомеры электромагнитные СИМАГ 23 (далее – расходомеры) предназначены для измерения объёмного расхода и объёма электропроводящих жидкостей, а также для использования в составе других средств измерений, в системах учета тепловой энергии, дозирования, АСУ ТП.

**Описание средства измерений**

Принцип работы расходомеров основан на законе электромагнитной индукции: в электропроводящей жидкости, движущейся в магнитном поле, индуцируется электродвижущая сила, пропорциональная скорости потока жидкости, которой, в свою очередь, пропорционален объёмный расход жидкости.

Расходомер состоит из первичного преобразователя расхода (далее – сенсор) и вторичного преобразователя расхода (далее – электронный блок). Сенсор представляет собой участок трубопровода из немагнитного материала, покрытого внутри неэлектропроводящим материалом - футеровкой, находящийся между полюсами электромагнита и электродов, помещенных в поток жидкости, в направлении перпендикулярном направлению движения жидкости и силовых линий магнитного поля. Электронный блок принимает и обрабатывает сигналы с сенсора, вычисляет объёмный расход, формирует выходные аналоговые и цифровые сигналы, хранит данные о накопленном объеме и ошибках в энергонезависимой памяти, выводит информацию на индикатор при его наличии.

Расходомеры изготавливаются в исполнениях:

- компактное;
- раздельное;
- комбинированное.

В компактном исполнении сенсор и электронный блок механически объединены в моноблок. В раздельном исполнении сенсор и электронный блок разнесены и соединяются электрическим кабелем. В комбинированном исполнении электроника частично размещается в клеммной коробке сенсора и соединяется с электронным блоком электрическим кабелем.

Расходомеры выпускаются с различными динамическими диапазонами расходов и погрешностями измерений, значения которых нормируются разными классами точности.

Расходомеры могут измерять объёмный расход и объем жидкости в прямом и обратном (реверсивном) направлениях потока. Расходомеры имеют пассивные либо активные аналоговые выходы 4-20 мА и частотно-импульсные выходы с открытым коллектором.

Для передачи цифровых данных и управления расходомером могут использоваться стандартные интерфейсы связи: RS-485 (Modbus RTU), Ethernet (Modbus TCP/IP), HART, Profibus, Foundation Fieldbus, Profinet, а также беспроводные каналы Bluetooth или Wi-Fi.

Общий вид расходомеров представлен на рисунках 1, 2, 3.



а)



б)



в)



г)



д)

Рисунок 1 – Общий вид расходомеров компактного и комбинированного исполнений:  
а, б, в, г) компактное исполнение; д) комбинированное исполнение




Рисунок 2 – Общий вид электронных блоков расходомеров раздельного исполнения




Рисунок 3 – Общий вид сенсоров раздельного исполнения.



Схема пломбировки расходомера от несанкционированного доступа, представлена на рисунке 4.

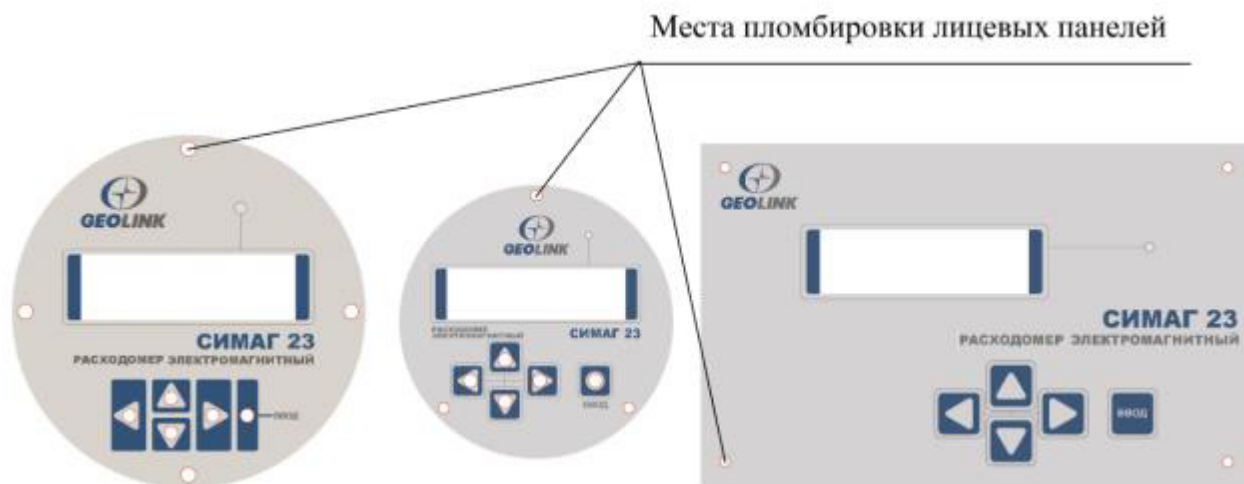

а)

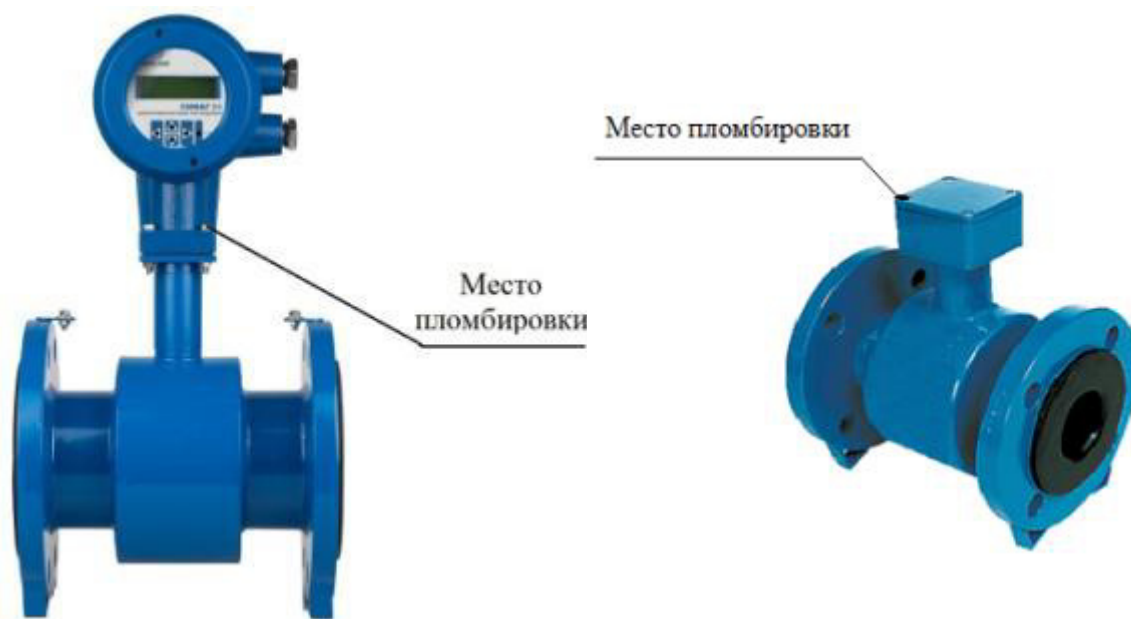

б)

в)

Рисунок 4 – Места пломбировки от несанкционированного доступа:

- а) винтов крепления лицевых панелей;
- б) болтов узла сочленения для компактного исполнения;
- в) винтов крышки клеммной коробки для раздельного и комбинированного исполнений

Серийный номер расходомера в виде набора арабских цифр наносится типографским способом на маркировочных этикетках рисунок 5,а, закрепляемых на боковой стороне сенсора и электронного блока, как показано на рисунке 5,б – 5,е. Нанесение знака поверки на расходомеры не предусмотрено.



Рисунок 5 – Вид маркировочной этикетки и места ее нанесения:  
а) вид маркировочной этикетки;  
б) этикетка на электронном блоке отдельного и комбинированного исполнения;  
в) этикетка на электронном блоке компактного исполнения вариант 1;  
г) этикетка на электронном блоке компактного исполнения вариант 2;  
д, е) этикетка на сенсорах.

### Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее – ПО) расходомеров является встроенным и устанавливается в энергонезависимую память при изготовлении. ПО обеспечивает обработку измерительной информации, отображение измерительной информации на ЖК-дисплее, обмен информацией с внешними устройствами по цифровым интерфейсам, а также её преобразование в нормированные токовый и частотно-импульсный выходные сигналы.

Уровень защиты ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений – «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	Симаг-23
Номер версии (идентификационный номер) ПО	4.XX.X
Примечание: Обозначение X в записи номера версии ПО заменяет символы, отвечающие за метрологически незначимую часть.	

### Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 – Основные метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение для класса точности			
	A (A1)	B (B1)	C (C1)	D (D1)
Диаметр условного прохода (Ду)	от 5 до 1600	от 2 до 1600	от 2 до 1000	от 2 до 1000
Динамический диапазон расходов	1:250 (1:200)	1:125 (1:100)	1:62,5 (1:50)	1:30 (1:25)
Пределы допускаемой, приведенной к переходному расходу, погрешности измерений объёмного расхода в диапазонах расходов, % $Q_{\min} \leq Q < Q_t$ <sup>1)</sup> $Q_{\min} \leq Q < Q_t$ для расходомеров с Ду от 2 до 8 мм $Q_{\min} \leq Q < Q_t$ при имитационной поверке <sup>2)</sup> с «Поток-Т» $Q_{\min} \leq Q < Q_t$ при имитационной поверке <sup>2)</sup> с «Артчек»	$\pm 1$ $\pm 1$ $\pm 1$ $\pm 1$	$\pm 0,5$ $\pm 0,5$ $\pm 0,6$ $\pm 0,75$	$\pm 0,25$ $\pm 0,3$ $\pm 0,5$ $\pm 0,75$	$\pm 0,2$ $\pm 0,25$ $\pm 0,5$ $\pm 0,75$
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объёмного расхода и объёма, в диапазонах расходов, % $Q_t \leq Q \leq Q_{\max}$ <sup>3)</sup> $Q_t \leq Q \leq Q_{\max}$ для расходомеров с Ду от 2 до 8 мм $Q_t \leq Q \leq Q_{\max}$ при имитационной поверке <sup>2)</sup> с «Поток-Т» $Q_t \leq Q \leq Q_{\max}$ при имитационной поверке <sup>2)</sup> с «Артчек»	$\pm 1$ $\pm 1$ $\pm 1$ $\pm 1$	$\pm 0,5$ $\pm 0,5$ $\pm 0,6$ $\pm 0,75$	$\pm 0,25$ $\pm 0,3$ $\pm 0,5$ $\pm 0,75$	$\pm 0,2$ $\pm 0,25$ $\pm 0,5$ $\pm 0,75$
Диапазон измерений объёмного расхода, м <sup>3</sup> /ч	от 0,0011 до 90477,9			
Рабочий диапазон частотного выхода, Гц	от 0,1 до 3000			
Пределы допускаемой относительной погрешности воспроизведения значения объёмного расхода по частотному выходу, %	$\pm 0,05$			
Выходной токовый сигнал, мА	от 4 до 20			
Пределы допускаемой приведенной к диапазону токового выхода погрешности преобразования объёмного расхода в токовый выходной сигнал, %	$\pm 0,5$ $\pm 0,05$ (опция)			



Продолжение таблицы 2

<p>Примечания:  <sup>1)</sup> <math>Q_t</math> – переходной расход, <math>Q_t = 3 \cdot Q_{min}</math>;  <sup>2)</sup> Имитационная поверка может применяться для расходомеров с Ду 20 мм и более;  <sup>3)</sup> <math>Q_{max}</math> – значение максимального расхода, указано в РЭ и паспорте расходомера.</p>
---

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Избыточное давление измеряемой среды, МПа, не более	10
Диапазон температур измеряемой среды, °С	от -60 до +180
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды °С - относительная влажность при температуре 35 °С без конденсации влаги, %, не более - атмосферное давление, кПа	от -60 до +70  98 от 84,0 до 106,7
Напряжение питания переменного тока частотой 50/60 Гц, В	от 110 до 250
Напряжение питания постоянного тока, В	от 12 до 48
Потребляемая мощность, не более: - для расходомеров с питанием от источника постоянного тока, В·А - для расходомеров с питанием от источника переменного тока, Вт	9 9
Длина соединительного электрического кабеля между сенсором и электронным блоком: - раздельного исполнения, не более, м - комбинированного исполнения, не более, м	200 1200
Габаритные размеры сенсора, мм, не более: - высота - ширина - длина	2000 1950 2000
Масса сенсора, кг, не более	1200
Габаритные размеры электронного блока раздельного и комбинированного исполнения, мм, не более: - высота - ширина - глубина	205 205 115
Масса электронного блока раздельного и комбинированного исполнения, кг, не более	1,5
Габаритные размеры электронного блока раздельного исполнения 1, мм, не более: - высота - ширина - глубина	240 180 235
Масса электронного блока раздельного исполнения 1, кг, не более	3,5

Продолжение таблицы 3

Габаритные размеры электронного блока отдельного исполнения 2, мм, не более: - высота - ширина - глубина	210 180 180
Масса электронного блока отдельного исполнения 2, кг, не более	1,8
Степень защиты электронного блока отдельного и комбинированного исполнения от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015	IP65/67/68
Степень защиты сенсора расходомера отдельного исполнения от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015	IP67/68
Степень защиты расходомера компактного исполнения от внешних воздействий по ГОСТ 14254-2015	IP67/68
Средний срок службы, лет	15
Средняя наработка на отказ, ч	150000

**Знак утверждения типа**

наносится типографским способом на маркировочную этикетку, закрепляемую на боковой стороне электронного блока и сенсора, как показано на рисунке 5 и на титульные листы руководства по эксплуатации и паспорта расходомера.

**Комплектность средства измерений**

Таблица 4 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Расходомер электромагнитный	СИМАГ 23	1 шт.
Соединительный кабель <sup>1)</sup>	–	1 шт.
Паспорт	ПМЕК.407111.010 ПС	1 экз.
Руководство по эксплуатации	ПМЕК.407111.010 РЭ	1 экз.
<sup>1)</sup> При отдельном или комбинированном исполнении, по запросу, с указанием длины		

**Сведения о методиках (методах) измерений**

приведены в разделах 3, 7, 8 руководства по эксплуатации ПМЕК.407111.010 РЭ.

**Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к средству измерений**

Приказ Росстандарта от 26 сентября 2022 г. № 2356 «Об утверждении Государственной поверочной схемы для средств измерения массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расхода жидкости»;

ПМЕК.407111.010 ТУ «Расходомеры электромагнитные СИМАГ 23. Технические условия».

**Правообладатель**

Общество с ограниченной ответственностью «Геолинк Ньютек»  
(ООО «Геолинк Ньютек»),  
ИНН 7710494607

Юридический адрес: 117105, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нагатинно-Садовники, Варшавское ш., д. 37А, стр. 2, эт. 2, помещ. №V, ком. №1А

**Изготовитель**

Общество с ограниченной ответственностью «Геолинк Ньютек»  
(ООО «Геолинк Ньютек»),  
ИНН 7710494607

Адрес: 117105, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Нагатинно-Садовники, Варшавское ш., д. 37А, стр. 2, эт. 2, помещ. №V, ком. №1А

Телефон: (495) 380-21-64

E-mail: [info@geolink.ru](mailto:info@geolink.ru)

Web-сайт: [www.geolink.ru](http://www.geolink.ru)

**Испытательный центр**

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГБУ «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул. Озерная, д. 46

Тел./факс: (495) 437-55-77, 437-56-66

Web-сайт: [www.vniims.ru](http://www.vniims.ru)

E-mail: [office@vniims.ru](mailto:office@vniims.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № 30004-13.

